



قسم الكيمياء الحيوية

نموذج استرشادي لإجابة امتحان نظري لمادة  
كيمياء الاجهزة والتحليل الدقيقة  
لطلاب الفرقة الرابعة - شعبة الكيمياء (مقرر اجبري)  
العام الجامعي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ الفصل الدراسي الاول

(٣٠ درجة)  
(٦ درجات)

السؤال الأول:-

١ تكلم باختصار عن كل مما يأتي :-

**Rt – Chromatogram -Packed column – Rf value - thermal conductivity detector – Flame ionization detector.**

**Rt** هو الوقت اللازم انقضاؤه من بدء حقن العينة حتى خروج المادة وظهور ال Peak

maximum على الكروماتوجرام.

**- تعريف التحليل الكروماتوجرافي :- Chromatography**

يمكن تعريف التحليل ال كروماتوجرافي بأنه طريقة لتحليل وفصل المركبات المختلفة وتعتمد على حدوث ما يسمى بالـ Differential Migration أى إختلاف فى إنتقال وهجرة المركبات نتيجة مرور مذيب أو غاز على الوسط المحتوى على المواد المراد تحليلها.  
- الأساس العلمى للطرق المستخدمة فى الفصل تعتمد على توزيع المركبات المختلفة بين طورين أحدهما :-


**- طور متحرك Mobile Phase**

**- طور ثابت Stationary Phase**

**الأعمدة الحلزونية : Packed Column**

وتستعمل فى هذه الأعمدة مادة حاملة كدعامة support فى صورة حبيبات صغيرة الحجم بينهما فراغات تسمح بمرور الغاز خلالها بمعدل مناسب كما يمكنها أن تتغلف بطبقة رقيقة من السائل المستخدم كطور ثابت ومن المواد المستعملة الزجاج المجروش أو الرمل أو بعض الأتربة الطبيعية والسوائل التى تعمل كطور ثابت وتمسك فى صورة غشاء رقيق يجب أن

تكون غير متطايرة وثابتة حراريا مثل زيت البرافين أو الزيوت المعدنية أو الجلسرين وغير ذلك من السوائل حسب نوع المركبات المراد فصلها .

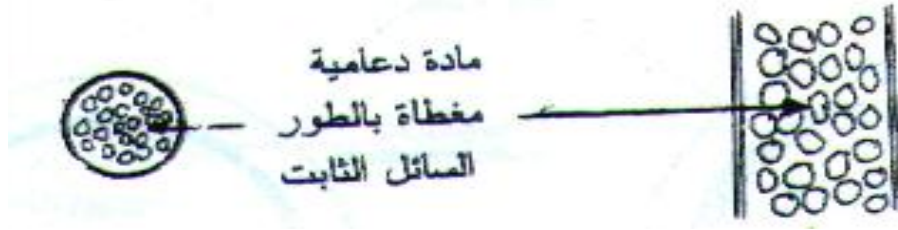

**RF:** - لكل مركب وذلك بقياس المسافة التي سارها المركب على المسافة التي سارها المذيب.

### Thermal conductivity detector جهاز الكشف القائم على التوصيل الحرارى

- حيث يوجد بخلية التوصيل الحرارى سلك رفيع ترتفع درجة حرارته بتأثير تيار كهربي وبمرور تيار ثابت من الغاز الخامل النقي فإن كمية الحرارة المفقودة من السلك تظل ثابتة وعندما يحمل تيار الغاز الخامل بعض المركبات المفصولة فإنه يحدث اختلاف فى درجة حرارة السلك يمكن تسجيله ومن الطبيعى فإن هذا الاختلاف يتوقف على كمية المركبات ونوعها وهو المطلوب الاستدلال عليه .

## ٢- أشرح طريقة فصل وتقدير المركبات باستعمال كلامن ( كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة ، التحليل الكروماتوجرافى السائل ( ٨ درجات )

### التحليل الكروماتوجرافى ذو الطبقة الرقيقة Thin layer chromatography

الأدوات التى تستخدم فى TLC ألواح زجاجية ، سليكاجيل - Spreader tray spreader ، plate holder .

\* أنواع السليكا جيل :

Silica gel H : - سليكا جيل ذو حبيبات دقيقة بدون كبريتات كالسيوم .

Silica gel G : - تحتوى على ١٣ % كبريتات كالسيوم .

Silica gel GF : - سليكاجيل مضاف إليها دليل فلورة .

Silica gel R : - تحتوى على ٥% كبريتات كالسيوم .

Silica gel D5 : - سليكاجيل D-5 مضاف إليها دليل غير عضوى مقلور .

Silica gel DF-5 : - سليكاجيل تحتوى على النشا كمادة لاصقة .

### \* ملحوظة:

تتحكم أقطار جزيئات المادة الإدمصاصية في كفاءة الفصل فمثلا طبقات الجزيئات في السليكاجيل ذات قطر يتراوح بين ١-٥ ميكرون يؤدي إلى فصل مناسب بينما الجزيئات الكبيرة تؤدي إلى تحرك المذيب بسرعة كبيرة وظهور بقع كبيرة جدا في الحجم نتيجة للانتشار الجانبي العالي وقلة مقدرتها على الإدمصاص.

### \* طريقة الفصل والتحليل :

هذا النظام من التحليل الكروماتوجرافي تابع لتحليل الكروماتوجرافيا الإدمصاص ويعتبر النظام الثابت Stationary phase عبارة عن مادة إدمصاص مثل ثاني أكسيد الألومونيوم أو السليكاجيل مخلوط بمادة لاصقة يتم فرد مادة الإدمصاص على طبقة رقيقة على شريحة زجاجية مقاس ٢٥ × ٢٠ سم.

أما النظام المتحرك mobile phase عبارة عن مذيب مناسب أو مخلوط من المذيبات المناسبة قبل استعمال الشرائح يتم وضعها في فرن للتخلص من الرطوبة ولتنشيط مادة الإدمصاص . ثم يتم وضع العينة المراد فصلها بواسطة أنبوبة شعرية دقيقة على هيئة بقع وعلى أحد أطراف الشريحة يوضع خط ويسمى بنقطة البداية على بعد ٢ سم وقبل انتهاء الشريحة بمسافة ٢ سم يوضع خط يسمى بخط النهاية.

تغمس الشرائح الزجاجية في حوض يحتوي على المذيب أو مخلوط من المذيبات ويقفل الحوض جيدا وبعد سريان المذيب حتى خط النهاية تخرج الشرائح وتجفف تحضير طبقات رقيقة ذات سمك واحد من السليكاجيل :

توجد عدة طرق لعمل الطبقات:

- ١) طريقة الصب
- ٢) طريقة الغمر
- ٣) طريقة الفرد
- ٤) طريقة الرش

التعرف أو الكشف على أماكن الفصل.

ترش الشرائح بجواهر كشافة لظهور مواضع المركبات المختلفة وقياس المسافة التي سارها المذيب والمسافة التي سارها مكونات العينة يمكن حساب RF .

\* التقدير الكمي بعد الاستخلاص :

نقش كل منطقة Zone وتوضع في أنبوبة زجاجية وتذاب في مذيب مناسب وترشح للتخلص من مادة الإدمصاص ثم يجرى عليها التقديرات الكمية الآتية .

- \* استخدام الأشعة فوق بنفسجية UV
- \* استخدام جواهر كشافه وقياس الكثافة الضوئية بإستخدام Spectrophotometer .
- \* التقدير الكمي على الورق أو اللوح :

توجد عدة طرق وهي

- (١) المقارنة البصرية
- (٢) التقدير بواسطة حساب مساحة البقع
- (٣) تقدير النفاذية للبقع الملونة أو المكربنة أو التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية.

### \* مميزات TLC عن Paper Chromatography

- (١) الوقت الذي يأخذ الفصل بواسطة TLC قصير جدا حيث لا يحتاج أكثر من نصف ساعة وبسيطة في حين أن الوقت الذي يأخذ Paper طويل يتراوح من ١٦ - ٢٤ ساعة .
  - (٢) تكون البقع مندمجة Compact والفصل ممتاز .
  - (٣) تستعمل مواد ادمصاصية كثيرة منه ا مواد عضوية مثل السيليلوز أو السيليلوز المحور أو غير عضوية مثل السليكاجيل أو الالومنيا . في حيث أن Paper يكون يعتمد فقط على الطبقة الرقيقة من السيليلوز .
  - (٤) تستعمل كميات قليلة من المواد المراد تحليلها كما إنها تستخلص كل مكونات العينة .
  - (٥) تستعمل مواد لتعيين موضع المركبات المفصولة مثل حمض الكبريتيك وترش على السليكاجيل أو الومنيوم دون أن تتأثر على العكس من التحليل الكروماتوجرافي الورقي .
- \* حجم المذيب الذي يستخدم في عمل Slurry = ٢.٥ × عدد الألواح × سمك اللوح (سم) × بعد اللوح (سم).
- \* النسبة بين الماء والسليكاجيل = ٢ : ١
- \* السليكاجيل تحتوى على كبريتات كالسيوم بنسبة ١٠% من وزنها.

## التحليل الكروماتوجرافي السائل

يعتبر الـ HPLC أحد الطرق الأساسية لتحليل المواد العضوية وهو يمتاز مثل طرق التحليل الكروماتوجرافي الأخرى بالدقة والحساسية العالية كما أن مدى استخداماته لاتعتمد على تطاير العينة أو تأثرها بالحرارة كما هو الحال في الـ GLC ويمتاز جهاز الـ HPLC بكفاءته العالية جداً على الفصل بالإضافة إلى استخدامه في فصل العديد من المركبات المختلفة مثل الفينولات ، الفيتامينات والسكريات.



### أساسيات جهاز الـ HPLC Principles of HPLC

يقوم جهاز HPLC بفصل مكونات العينة ثم التعرف عليها وتقديرها كميًا. ويتم الفصل عن طريق توزيع العينة ما بين طورين أحدهما الطور المتحرك (سائل) والآخر طور ثابت (سائل أو صلب) وعادة يكون الطور الثابت في عمود طوله حوالي ٢٥ سم وقطره ٤ م.م. وتعتمد كفاءة الفصل على مواصفات العمود وبصفة خاصة قطر جزيئات المادة المعبأة ويلاحظ أن خفض قطر الجزيئات يؤدي إلى تحسين أداء العمود بالإضافة إلى أنه يرفع الضغط بالتالي نحصل على معدل سريان مناسب للطور المتحرك خلال العمود ولهذا السبب فإن أجهزة HPLC الحديثة يطلق عليها أجهزة الضغط العالي الكروماتوجرافي السائل حيث تدفع المضخة الطور المتحرك داخل عمود الفصل والذي بدوره يفصل العينة لمكوناتها والتي تمر خلال الـ Detector حيث عندما يمر كل مكون من مكونات العينة خلال الـ Detector فإنه يحدث تغير في الإشارات الكهربائية يتم تسجيلها على خريطة متحركة لتعطي كروماتوجرام.

### ماهو الاساس العلمى الذى بنى عليه جهاز الامتصاص الذرى Atomic Absorbption مع شرح مبسط (٨ درجات)

يحدث الامتصاص الذرى بأن تمتص الذرات الموجودة في حالتها المنفردة الأشعة الضوئية عند طول موجي معين وتنتقل إلى الحالة المثارة وتزداد كمية الأشعة الممتصة عند هذا الطول الموجي بزيادة عدد ذرات العنصر الموجودة في مسار الأشعة والعلاقة بين كمية الأشعة الممتصة وتركيز العنصر المراد تقديره يمكن الحصول عليها باستعمال مادة قياسية معروفة التركيز تحتوى على العنصر المراد تقديره.

### \* تركيب الجهاز : Instrument structure

يتركب الجهاز من الأجزاء الآتية :

١ - مصدر الأشعة **Radiation source**

٢ - وحدة تحويل العناصر إلى الصورة الذرية **Atomizer (Burner system)**

٣ - وحدة فصل الأطوال الموجية **Monochromator**

٤ - وحدة قياس طاقة الأشعة **Detector**

---

3- To prepare a standard soln. 15 ml of 0.0215 M soln. of  $KMnO_4$  was diluted to 500 ml. A series of standard was prepared by diluting from 1 to 10 ml of the main soln. at intervals of 1 ml in 25 ml of water. A steel sample having a mass of 0.5 g was dissolved in acid and after appropriate treatment the soln. was diluted to 100 ml. The resulting soln. had a color intermediate between the fourth and fifth standards.

Calculate the percentage of the Mn in the steel.

( ٨ درجات )

$$\text{Con. of stock solution} = 15 \times 0.0215 = 500 \times C$$

$$C = (15 \times 0.0215) / 500 = 0.000645 \text{ M}$$

$$\text{Con. of fourth standard} = 4 \times 0.000645 = 25 \times C$$

$$C = 0.0001032 \text{ M}$$

$$\text{Con. of fifth standard} = 5 \times 0.000645 = 25 \times C$$

$$C = 0.000129 \text{ M}$$

$$\text{Con. of steel solution} = (0.0001032 + 0.000129) / 2$$

$$= 0.0001161 \text{ M}$$

Percentage of Mn of steel

$$= (0.0001161 \times 100 \times 55 \times 100) / (1000 \times 0.5) = 0.13\%$$

.....

السؤال الثاني:  
( ٣٠ درجة )



- أ - أذكر أنواع Ion exchange chromatography مع ذكر مثال.
- ب ماذا يعنى الفصل بـ Gel filtration.
- ج- كيف يمكن تقدير الحمض الأميني بواسطة جهاز الـ Amino acid analyzer مبينا تركيب الجهاز وتجهيز العينة وميكانيكية الفصل وتفاعل النيهيدرين مع الأحماض الأمينية الخارجه من العمود وعيوب هذه الطريقة وكيفية التغلب عليها.
- د- ما هي الأنواع المختلفة للفصل الكهربى وماذا يقصد بكل من مع الشرح:
- SDS-PAGE.
  - Factor affecting migration of protein.
  - Formation of polyacrylamide gels.
- 

### أذكر أنواع Ion exchange chromatography مع ذكر مثال.

- Ion Exchange Chromatography حيث يعتمد فصل وتحليل المركبات علي إمكانية تبادلها مع الأيونات الموجودة علي سطح مواد خاصة تعرف بمواد التبادل الأيوني Ion exchanger وهي عبارة عن مادة غير ذائبة تحتوي علي بعض المجموعات التي تحمل شحنات ويحيط بها أيونات ذات شحنات مضادة وهذه الأيونات حرة الحركة بعكس المجموعات المشحونة التي تكون مرتبطة كيميائيا بجزئيات المادة التبادل الأيوني . ويمكن استبدال الأيونات بأيونات أخرى تحمل نفس الشحنة دون أن تتأثر المادة الأصلية تسمى matrix . فإذا كانت المادة matrix تحمل شحنات موجبة فإن الأيونات المحيطة بها تكون سالبة وبالتالي فإن المادة يمكن أن يتم عليها تبادل أيونات سالبة الشحنة ول ذلك يطلق عليها اسم Anion exchanger والعكس إذا كانت المادة الأصلية matrix تحمل شحنات سالبة فإن الأيونات المحيطة بها تكون موجبة الشحنة وبالتالي يمكنها التبادل مع أيونات موجبة مع أيونات موجبة ولذلك تسمى Cation exchanger كما في الشكل:

**\*It is possible to have both positively and negatively charged exchangers.**

- \* Positively charged exchangers have negatively charged counter-Ions (anions) available for exchange and so are termed anion exchangers.
- \* Negatively charged exchangers have positively charged counter ions (cations) and are termed cation exchangers.\*



**Anion exchanger with  
exchangeable counter-ions**

**Cation exchanger with  
exchangeable counter-ions**

$$\text{Relative mobility} = \frac{\text{Distance of protein}}{\text{length after distaining}} \times \frac{\text{Length before distaining}}{\text{Disatnce of day migration}}$$

### أ - ماذا يعنى الفصل بـ Gel filtration.

حيث يعتمد فصل المركبات المختلفة على اختلاف حجمها الجزيئي molecular size مما يسبب اختلافها في النفاذية permeability بين حبيبات مواد في صورة جيل واشهرها مادة Sephadex فجزئيات المركبات الكبيرة الحجم لا يمكنها النفاذ داخل فراغات الجيل لذلك فهي تمر اسرع مع المذيب بعكس الجزيئات الاخرى الصغيرة الحجم واذى يمكنها النفاذ فى الفراغات الموجودة بين حبيبات الجيل لذلك تخرج المركبات بالتتابع على حسب تناقص حجمها الجزيئي وتعرف ميكانيكية الفصل هذه بال Molecular exclusion.

### ج - عينة نباتيه كيف يمكن تقدير الأحماض الأمينية بها بواسطة جهاز

**Amino acid analyzer** مبينا تجهيز العينه - ميكانيكية الفصل وعيوب

هذه الطريقة وكيف يمكن التغلب عليها.


-: جهاز تحليل الأحماض الأمينية

**Amino acid analyzer**

تقدر الأحماض الأمينية وصفيًا وكميًا باستخدام عمود يحتوى علي راتنج التبادل الأيوني ويمرر خلاله الطور المتحرك حاملاً معه الأحماض الأمينية المفصولة كل علي حدة ثم يتفاعل مع الننهيدرين ويتكون معقد لوني . والجهاز يعتمد أساساً علي ضخ Pumped محاليل منظمة تختلف في درجة حموضتها أو قوتها الأيونية Ionic strength خلال عمود الراتنج Resin column المزود بترموستات لضبط درجة حرارته . وقد حدث تطور في الجهاز باستخدام راتنجات ذات نوعية عالية ونظام للحقن الآلى ، مع أنظمة للكشف ذات حساسية عالية . وهذا



أدى إلى تقليل وقت التحليل من أيام إلى ساعات . الإضافة إلى تقديرها كميًا حتى وإن كان تركيز الأحماض الأمينية أقل من  $10^{-9}$  مولر.

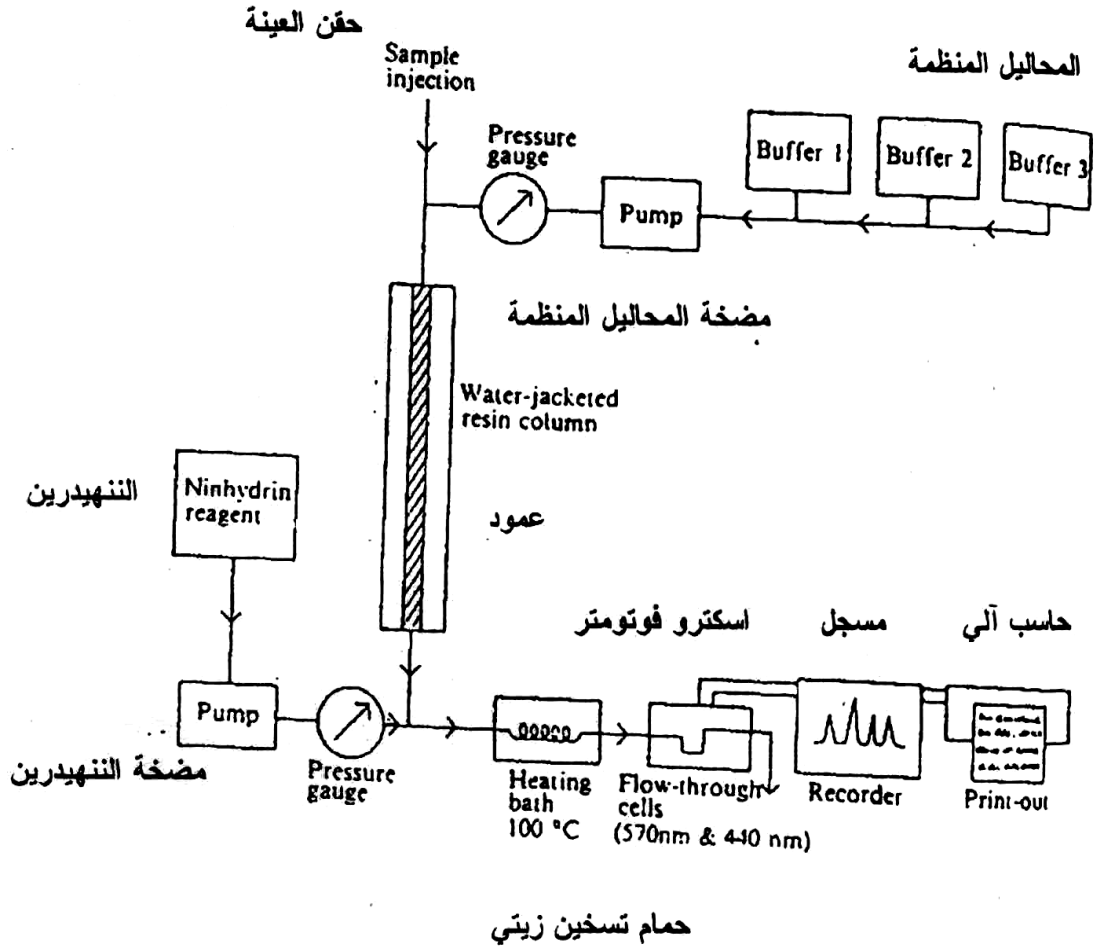

رسم تخطيطي لجهاز تحليل الأحماض الأمينية باستخدام النيهيدرين للتقدير الكمي

الشكل التخطيطي السابق يبين أجزاء جهاز تحليل الأحماض الأمينية وهي:


١. محاليل منظمة ذات درجة حموضة مختلفة عادة يستخدم ثلاث محاليل منظمة ١ ، ٢ ، ٣ لها درجة حموضة ٣.٢٥ ، ٤.٢٥ ، ٥.٢٨ علي التوالي وتعمل كطور متحرك لإحلال الأحماض الأمينية .
٢. مضخة لدفع المحاليل المنظمة داخل العمود Buffer pump .
٣. وسيلة لحقن العينة Sample injection .
٤. عمود راتنج وبه وسيلة لضبط وثبات درجة حرارة الفصل Resin column .
٥. مضخة لدفع الجوهر الكشاف ننهيدرين Ninhydrin pump .
٦. حمام زيتي Reaction coil .
٧. خلية لتقدير الكثافة اللونية للمحلول Flow cell عند الطولين الموجين ٥٧٠ و ٤٤٠ نانوميتر .
٨. مسجل أو حاسب ألي Computer .

تقدير الأحماض الأمينية :


لتقدير الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات لابد من إجراء عملية التحليل الحامضى للسلاسل الببتيدية وذلك بالتسخين علي درجة ١١٠°م في وجود حامض HCl بتركيز ٦ عيارى لمدة ٢٤ ساعة وبعد ذلك يتم التخلص من الحامض الزيادة والتجفيف ثم تذاب العينة في محلول منظم من السترات pH = ٣ ثم تحقن العينة في جهاز تقدير الأحماض الأمينية Amino acid analyzer .

طريقة الفصل :

فصل الأحماض الأمينية يكون علي أساس التبادل الأيوني Ion exchange chromatography ويتكون الجهاز من عدد ٢ عمود :  
العمود الأول Short column: يستخدم في فصل الأحماض الأمينية القاعدية .  
العمود الثاني Long column: يستخدم في فصل باقى الأحماض الأمينية .  
كل من العمودين مملوء بمادة ذات شحنة سالبة عليها ايون الصوديوم تسمى (Sulfonated polystyrene resin Na<sup>+</sup> form) .

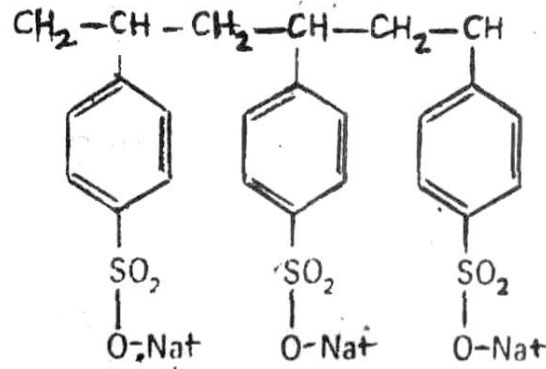

ف عند إضافة المحلول الحامض لمخلوط الأحماض الأمينية  $\text{pH} = 3$  للعمود المعبأ بالمادة فإن الأحماض الأمينية القاعدية ترتبط مع مادة العمود بقوة بينما الأحماض الأمينية الحامضية ترتبط برابطة ضعيفة بمادة العمود وباستعمال محاليل منظمة مختلفة في درجة الحموضة  $\text{pH}$  فإنه يمكن فصل Elution كل نوع من الأحماض علي حدة . والشكل التالي يوضح ذلك :

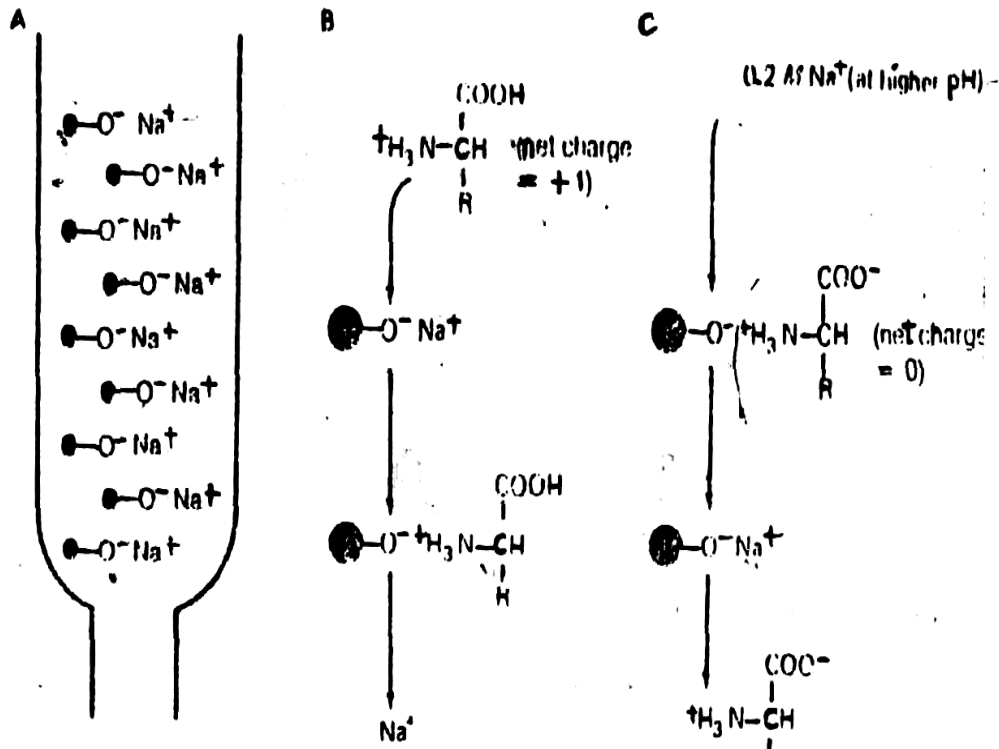

(A) عمود مملوء بمادة تبادل كاتيوني Sulfonated polystyrene resin-  $\text{Na}^+$  form

(B) تبادل الحامض الأميني مع أيون الصوديوم .


(C) إحلل  $\text{Na}^+$  محل الحامض الأميني باستخدام محلول ذو  $\text{pH}$  عالي.

الحامض الأميني الذي يخرج من العمود بعد إجراء عملية Elution يتفاعل مع

الننهيدين علي درجة  $100^\circ\text{M}$  ويعطى لون بنفسجي ويتم قياس تركيز اللون باستخدام جهاز

Colorimeter. كل الأحماض الأمينية الموجودة في صورة  $\alpha$ -amino acids تعطي اللون البنفسجي بينما الحامض الأميني البرولين والحامض الأميني هيدروكسي برولين يعطي لون أصفر حيث أنه لا يوجد في صورة  $\alpha$ -amino acids ومن عيوب التحليل الحامض للبروتينات يعمل علي تحويل الجلوتامين إلي جلوتاميك والاسبراجين إلي إسبراتييك .  
 ويعمل أيضا علي أكسدة الأحماض الأمينية الكبريتية والترتوفان ولكي نقلل من عملية الأكسدة يتم أثناء عملية التحليل الحامض إضافة مواد مانعة للأكسدة مثل المركبتوايثانول أو الثيوجليكوليك أسد.

ومعادلة تفاعل الننهيدرين تكون علي الصورة التالية:

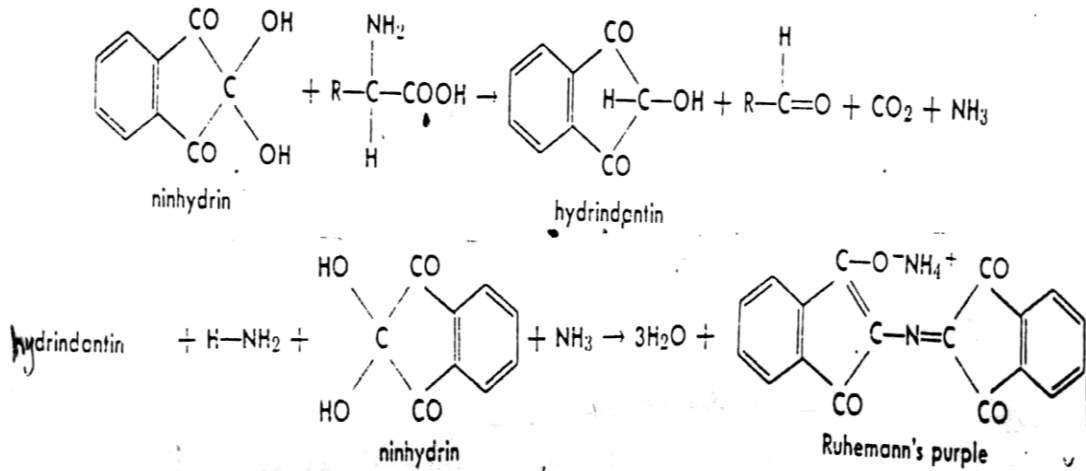

يتكثف ناتج تفاعل الننهيدرين مع الأمونيا مكونا مركب لونه أزرق أو بنفسجي ويتطلب هذا التفاعل وجود حامض أميني به مجموعة أمين منفردة في الموضع ألفا

د- ما هي الأنواع المختلفة للفصل الكهربى وماذا يقصد بكل من مع الشرح:

- SDS-PAGE.
- Factor affecting migration of protein.
- Formation of polyacrylamide gels.
- SDS-PAGE.

• يستخدم في تحليل ومعرفة عدد وحجم السلاسل البروتين polypeptide

البروتين المحضر يعامل بزيادة من soluble thiol


- Sodium dodecyl sulfate(SDS), ( $R= SH$ , e.g Bmercaptoethanol)
- وجد أن روابط (s-s) تحول إلي  $R-SH$  وتتفرد السلاسل البيتيديية كل علي حده وتتفصل كل سلاسل بيتيديية متشابهة في band واحد ويمكن تقدير التحرك من المعادلة السابقة

$$\text{Relative mobility} = \frac{\text{Distance of protein}}{\text{length after distaining}} \times \frac{\text{Length before distaining}}{\text{Distance of day migration}}$$

العوامل التي تؤثر على معدل تحرك جزيئات البروتين في المجال الكهربائي:

### Factors affecting migration

أ - الشحنة **Charge**: يزداد معدل التحرك بزيادة الشحنة النهائية Net charge وهي تعتمد بصفة عامة على درجة حموضة الوسط PH. وفيما يلي تأثير تغير درجة حموضة الوسط على الشحنة في البروتينات والأحماض الأمينية كـ بعض أمثلة:



تعرف الـ PH التي يكون عندها صافي الشحنة الكهربائية net charge الجزئ البروتين أو الحمض الأميني يساوي صفر باسم نقطة التـ عدل الكهربائي Isoelectric point ومن هذه الدرجة من PH لا يتحرك الجزئ في المجال الكهربائي ويعبر عن الـ PH والمقابلة لنقطة التعادل الكهربائي (Isoelectric PH) PI.

يمكن حساب قيمة الـ PH في المحلول بمعرفة معامل انقسام المجموعة المتأينة فمثلا في حالة الأحماض الأمينية الأحادية الأمين والكربوكسيل فإن  $Pka_1$  هي معامل انقسام مجموعة  $Pka_2, \text{COOH}$  هي معامل انقسام مجموعة  $\text{NH}_2$  وبحسب قيمة PI لما يلي

$$PI = 1/2 (Pka_1 + Pka_2)$$

مثال:  $Pka_1$  للحمض الأميني جليسين = 2.3 -  $Pka_2 = 9.6$

$$PI = 1/2 (2.3 + 9.6) = 6$$

أما في حالة الأحماض الأمينية ثنائية الكربوكسيل (جلوتاميك - اسبارتيك) تحتوي على ثلاثة مجاميع قابلة للتأين وبالتالي يكون لها ثلاثة  $Pka$  وبكتابة حالات التأين المحتملة لحمض الاسبارتيك بدء من الوسط الحامضي الشديد ثم تزداد PH حتى تصل إلى القاعدي مروراً بحالة التعادل.

### ب - الحجم Size

يقل معدل التحرك بالنسبة للمركبات ذات الأوزان الجزيئية الكبيرة نظراً لزيادة الاحتكاك وقوى التجارب الالكتروستاتيكي الناتجة من الوسط المحيط - فالجزيئات البلورية (ذات جزئ

صغير) لا تتأثر نسبيا بالادمصاص علي الورق في حين أن الجزيئات الفردية (ذات وزن جزئي كبير) جزئيا علي الوزن وتترك trail tailing خلف كل شريط من المواد المفصولة الرئيسية.

### ج- الشكل Shape:

تظهر الجزيئات ذات الحجم المتساوي والتي تختلف في شكلها مثل الب روتين الليفي والدائري اختلاف متباين في تحركها نظرا لاختلاف تأثير الاحتكاك وقوى التجاذب الالكتروستاتيكي.

ويمكن وضع العوامل التي تؤثر علي معدل التحرك في المعادلة التالية

$$\text{Mobility of molecule} = \frac{\left( \begin{array}{c} \text{Applied} \\ \text{voltage} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \text{Net charge} \\ \text{on the molecule} \end{array} \right)}{\left( \begin{array}{c} \text{Friction of the molecule} \\ \text{Molecular size and shape} \end{array} \right)}$$

---

### • Formation of polyacrylamide gels.

---

